Mode d'emploi des tests SNAP®

snap®

■ Préparation du test SNAP sanguin*

1. Homogénéiser l'échantillon et le conjugué dans le tube échantillon.



2. Verser le contenu du tube dans le puits échantillon.

3. Dès l'apparition d'une coloration dans le cercle d'activation, appuyer pour activer le SNAP.



4. Lecture du résultat au bout de: (voir tableau).

		Gouttes Conjugué	Gouttes Echantillon	Temps de lecture
Canins	3Dx®	4	3	8
Canins	Dirofilariose	4	3	8
Canins	Leishmaniose	6	2	6
Félins	Combo Plus FeLV/FIV	4	3	10

Interprétation des résultats

La coloration des résultats positifs peut varier en intensité.

Intensité du résultat positif

Très faible · Faible · Clair · Moyen · Fort

3Dx® Dirofilariose/Lyme/E.canis

Dirofilariose Positif | *E. canis* Positif | Lyme Positif | Dirofilariose/*E. canis* Positif | Lyme/*E. canis* Positif | Dirofilariose/Lyme/*E. canis* Positif

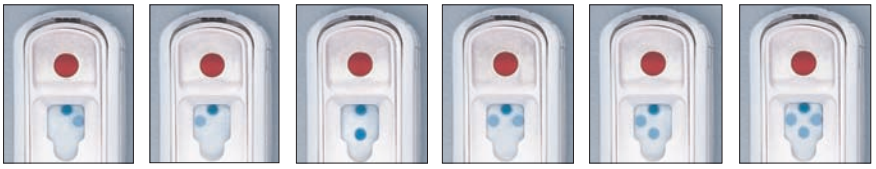

Dirofilariose

Dirofilariose (FAIBLE) Positif | Dirofilariose (FORT) Positif



Leishmaniose

Positif

Combo Plus FeLV/FIV

FeLV Positif | FIV Positif | FeLV/FIV Positif

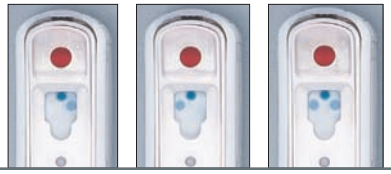

Résultat négatif

Sur tous les tests

Exemple: positif "faible"

Dirofilariose

■ Préparation du test SNAP parvo*

1. Enduire l'écouvillon et le replacer à l'intérieur du tube extracteur. Plier le réservoir et libérer le conjugué.

2. Presser et relâcher le réservoir 3 fois pour mélanger échantillon et conjugué.

3. Presser le réservoir afin de déposer 5 gouttes dans le puits échantillon.

4. Dès l'apparition d'une coloration dans le cercle d'activation, appuyer pour activer le SNAP.

5. Lecture du résultat au bout de: (voir tableau).

	Presser le réservoir	Gouttes du mélange échantillon + conjugué	Temps de lecture
Parvo	3	5	8
Giardia	3	5	8

Interprétation des résultats

La coloration des résultats positifs peut varier en intensité.

Intensité du résultat positif

Très faible · Faible · Clair · Moyen · Fort

Parvo

Positif

Giardia

Positif

Résultat négatif

IDEXX LABORATORIES

Pour toute information technique, veuillez appeler au:

00800 1234 3399

*Avant de procéder au test, veuillez lire le mode d'emploi détaillé qui se trouve dans le coffret.

IDEXX S.A.R.L.
Parc d'Activités des Bellevues, Bât. Floride
11 Avenue Rosa Luxembourg, BP 50232,
95614 Cergy-Pontoise Cedex
www.idexx.fr

© 2007 IDEXX Laboratories, Inc. • 09-60049-07 FR